

OSKA® | PULSE

دليل المستخدم

العربية

אוסקה®

للدعم الفني وخدمة العملاء:
اتصل بالموزع المحلي



היצרן:

Oska, Inc. DBA Oskaka Wellness
רחוב ג'פרסון 2725, מס' 15א,
קרלסבד, קליפורניה 92008
ארה"ב

הנציג האירופאי:

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP
האג
הולנד



בעל רישום, יבואן ומשווק בלעדי:

אלפא מד
שדרות גיבורי ישראל 5א
אזור התעשייה החדש, נתניה 4250405, ישראל
טלפון: 1-700-70-00-70
פקס: +972-722799050
דוא"ל: info@alpha-med.co.il
מספר הרישום בפנקס האמ"ר: 28110004

رجى قراءة جميع التعليمات قبل الاستعمال

ملاحظة: ستحتاج إلى شحن **Oska® Pulse** قبل الاستخدام.

راجع شحن **OSKA PULSE** (القسم 7) في هذا الدليل

اتصل بفريق خدمة عملاء **Oska** المحلي الخاص بك إذا:

- إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تركيب أو استخدام أو شحن أو صيانة **Oska® Pulse**
- للإبلاغ عن أي حدث أو عملية غير متوقعة **Oska، Inc.** أو احتجت معلومات اتصال الموزع المحلي الخاص بك

احتفظ بهذه التعليمات

جدول المحتويات

5	1. المقدمة
5	2. الاستخدام المقصود
6	3. موانع الاستخدام
7	4. التحذيرات
9	5. الاحتياطات
11	6. محتويات الطرد
12	7. شحن Oska Pulse
14	8. تشغيل Oska Pulse
16	9. استخدام لفافات الانضغاط
18	10. العناية بالجهاز وصيانته
19	11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
19	12. الوصف الفني
20	13. المواصفات
21	14. الرموز
23	15. معلومات الضمان

1. مقدمة

Oska Pulse هو جهاز يمكن ارتدائه ومحمول ولاسلكي وقابل لإعادة الشحن ومبرمج مسبقًا وسهل الاستخدام للحقل الكهرومغناطيسي النبضي (PEMF).

يمكن ارتداء **Oska Pulse** في المنطقة المستهدفة أو بالقرب منها، تحت أو فوق الملابس. (ملاحظة: إن الطبقات السميكة أو المتعددة من الملابس يمكن أن تعيق المجال الكهرومغناطيسي النبضي). ينبعث من الجهاز مجال كهرومغناطيسي نبضي يمر عبر جميع أنواع الأنسجة في الجسم، للعمل مع جسمك من أجل الانتعاش الطويل الأجل.

قد تختلف الاستجابة الفردية للعلاج ووقت التعافي. قد يبدأ البعض في الشعور بالراحة في غضون أسبوعين فقط، بينما يستغرق الأمر وقتًا أطول بالنسبة للكثيرين. لتحقيق أفضل النتائج، فيتوجب الاستخدام المتكرر والمتسق. أولئك الذين يمثلون لدمج **Oska Pulse** في حياتهم اليومية سيحصلون على أكبر قدر من الفائدة.

مع **Oska Pulse** لن تشعر بالحرارة الشديدة أو النبض أو الوخز. قد يلاحظ البعض ارتفاعًا طفيفًا في درجة حرارة المنطقة المستهدفة بسبب زيادة تدفق الدم.

2. الهدف من الاستخدام

Oska Pulse هو جهاز مجال كهرومغناطيسي غير جراحي يُقصد به استخدامه بمفرده أو كعلاج مساعد للمساعدة على الشفاء من الحالات الموجودة، وتقليل الالتهاب، وكعلاج إضافي في علاج حالات الالتهاب العظمي الجسيمي أي: التهاب المفاصل.



3. موانع الاستخدام

- تشمل نسبة مرضى Oska Pulse الرجال والنساء الذين ليس لديهم أي من موانع الاستخدام التالية:
- لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان أو أي جهاز طبي مزروع آخر، إلا إذا وافق طبيبك لأول مرة.
 - لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك غرسة مصنوعة من مواد مغناطيسية أو معدنية. اسأل طبيبك أولاً إذا كنت غير متأكد.
 - لا تستخدم الجهاز إذا تلقيت حقنة كورتيكوستيرويد. استشر طبيبك قبل الاستخدام.
 - لا تستخدم الجهاز إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة.
 - لا تستخدم الجهاز ما إذا كنت مصاباً بالسرطان أو تتلقى علاجاً للسرطان ما لم تكن قد استشرت طبيبك وتمت الموافقة على استخدامه.
 - لا تستخدم الجهاز إذا كنت تشعر بالألم ولكنك لا تعرف سبب أو أصل ألمك. استشر طبيبك قبل الاستخدام.
 - لا تستخدم إذا كان لديك ميل للنزيف بعد الإصابة الحادة أو كسور في العظام.
 - لا تستخدم إذا كنت أنت أو أي شخص آخر، بما في ذلك الأطفال، قد قللت من القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم إعطاؤك التعليمات والإشراف المناسبين.

4. التحذيرات

- لا تستخدم جهاز Oska Pulse بالقرب من معدات المراقبة الطبية (على سبيل المثال، أجهزة مراقبة القلب، تتبع القلب، أجهزة تشبع الأكسجين)، والتي قد لا تعمل بشكل صحيح عندما يكون Oska Pulse قيد الاستخدام.
- لا تضع Oska Pulse بالقرب من معدات التصوير بالرنين المغناطيسي التشغيلية لأنها قد تؤثر سلبيًا على تشغيل Oska Pulse من خلال التداخل الكهرومغناطيسي وكذلك القوة المغناطيسية.
- لا تستخدم Oska Pulse بالقرب من المنتجات التي قد تحتوي على مجالات مغناطيسية قوية، مثل موجات الميكروويف أو مكبرات الصوت القوية. قد لا يعمل الجهاز بشكل صحيح حول هذه المنتجات.
- محول شحن التيار المتردد (AC) الذي يتم توفيره مع Oska Pulse هو محول معتمد من الدرجة الطبية. في حالة استخدام محول AC آخر غير Oska المورد، يرجى التأكد من وجود محول معتمد لمعيار سلامة الجهاز الطبي (IEC 60601-1) مع إخراج مميز من الفئة 2 أو تلبية متطلبات مصدر الطاقة المحدود (LPS)، وعدم تجاوز V16.
- استخدم فقط كابل الشحن USB الذي تم تزويدك به مع Oska Pulse. قد يؤدي استخدام الكابلات التي لم تقدمها شركة Oska Inc. إلى إتلاف أو حرق جهاز Oska Pulse. اتصل بخدمة عملاء Oska للحصول على بديل.
- قم دائمًا بتخزين Oska Pulse بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب خطر الاختناق الناتج عن الاستنشاق أو ابتلاع طفل لجزء صغير قد انقطع أو انفصل.

- أبق كابل الشحن ولفافات الانضغاط بعيدًا عن متناول الأطفال لأن الاختناق قد ينتج عن التشابك.
- لا تعدل أو تصلح جهاز Oska Pulse. قد تسبب الحواف الحادة أو المكونات الكهربائية إصابة أو صدمة كهربائية. أعد الجهاز إلى Oska Inc. للفحص إذا كنت تعتقد أن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح.
- تبلغ درجة حرارة سطح جهاز Oska Pulse أكثر من 41 درجة مئوية (105 درجة فهرنهايت) عند شحن الجهاز.
- لا تستخدم Oska Pulse أثناء شحن الجهاز أو توصيله بمصدر طاقة.
- لا تربط Oska Pulse بمصدر عالي الطاقة.
- لا تستخدم أو توقف عن الاستخدام إذا أصبح سطح الجهاز ساخنًا.
- لا تستخدم Oska Pulse بالقرب من الحرارة أو النار، مثل المدفأة والسخان المشع، إلخ..
- لا ترمي الجهاز أو البطارية في النار.
- لا تستخدم Oska Pulse في بيئة غنية بالأكسجين أو بالقرب من معدات الأكسجين (مثل أسطوانة الأكسجين أو مولد الأكسجين أو المركز، إلخ).
- تخلص من الجهاز وبطاريته وفقًا للوائح المحلية.
- احتفظ بجميع الأجهزة الكهربائية (بما في ذلك Oska Pulse والشاحن وإمدادات الطاقة) بعيدًا عن السائل والماء، بما في ذلك الحمامات والاستحمام والمراحيض والأحواض.
- لا تغمر أو تسقط Oska Pulse في أي سائل في أي وقت، بما في ذلك أثناء استخدام الجهاز أو شحنه أو تشغيله.

- لا تستخدم أو تشحن Oska Pulse إذا تعرض أو عُمر في سائل لأن التعرض للسوائل قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للمكونات الإلكترونية.
- لا تستخدم الجهاز أو حزام الضغط بين المستخدمين دون التنظيف والتطهير المناسبين بسبب خطر التلوث، مثل ملامسة سوائل الجسم والغازات المنتهية الصلاحية، إلخ. استخدم طريقة Oska Inc. الموصى بها للتنظيف والتطهير أو اتبع تعليمات مؤسستك.
- الجهاز مصمم لمستخدم واحد.

5. الاحتياطات

- إذا كنت تشك في أن لديك رد فعل سلبي من استخدام جهاز المجال الكهرومغناطيسي، توقف عن الاستخدام واستشر طبيبك على الفور.
- إذا كنت قد خضعت مؤخرًا أو تخطط لإجراء أي عملية جراحية أو عملية ليزر/تجميل، فيرجى استشارة طبيبك قبل استخدام Oska Pulse.
- لا تضع اللقافة بإحكام شديد لأنه قد يؤثر على الدورة الدموية.
- لا تستخدم الصابون أو المنظف أو المبيض أو أي عامل تنظيف آخر لا توصي به شركة Oska Inc. قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز.
- لا تحفظ Oska Pulse في ضوء الشمس المباشر أو على سطح ساخن.

- لا تحفظ Oska Pulse أو أي من أجزائها في سيارة في طقس بارد أو حار.
- إذا بدأ الجهاز في توليد الحرارة، أوقف الجلسة، أو افصل الجهاز على الفور، وضع الجهاز في مكان بارد. لا تلمس الجهاز المحموم بشكل مباشر.
- ينبغي تشغيل الجهاز ونقله وحفظه بالطريقة المحددة في هذا الدليل في قسم المواصفات في هذا الدليل.
- توخى الحذر قبل استخدام الجهاز إذا كان في حالة تخزين أو عدم استخدام Oska Pulse لفترات طويلة. تفقد الجهاز ولا تستخدم الجهاز إذا رأيت أي علامات على تسرب بطارية داخلية.
- أبعد الجهاز دائماً عن الحيوانات الأليفة لتجنب تلف الجهاز، أو المخاطرة من الأسلاك المكشوفة والأشياء الصغيرة والحادة.
- تمت الموافقة على Oska Pulse للنقل الجوي والبري. ومع ذلك، يرجى، عند الطلب، تسليم الجهاز إلى السلطات المعنية للتفتيش.
- لا تتخلص من الجهاز كنفايات منزلية. اتصل بسلطاتك المحلية لتحديد الطريقة الصحيحة للتخلص من المعدات الإلكترونية.

6. محتويات الطرد

تحتوي مجموعة Oska Pulse الخاصة بك على العناصر التالية:

- جهاز Oska Pulse واحد
- 1 لفافات انضغاط ذات
- 1 كابل شحن USB
- 1 محول طاقة AC مع مجموعة محول Prong
- 1 دليل المستخدم (ليس مصوراً).




الشكل 1: محتويات Oska Pulse

* قد يختلف بناءً على نموذج Oska Pulse

7. شحن OSKA PULSE

قد يكون الشحن مطلوبًا قبل الاستخدام. لشحن Oska Pulse الخاص بك، قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو محول شحن AC و قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ الإرساء في نهاية جهاز Oska Pulse.

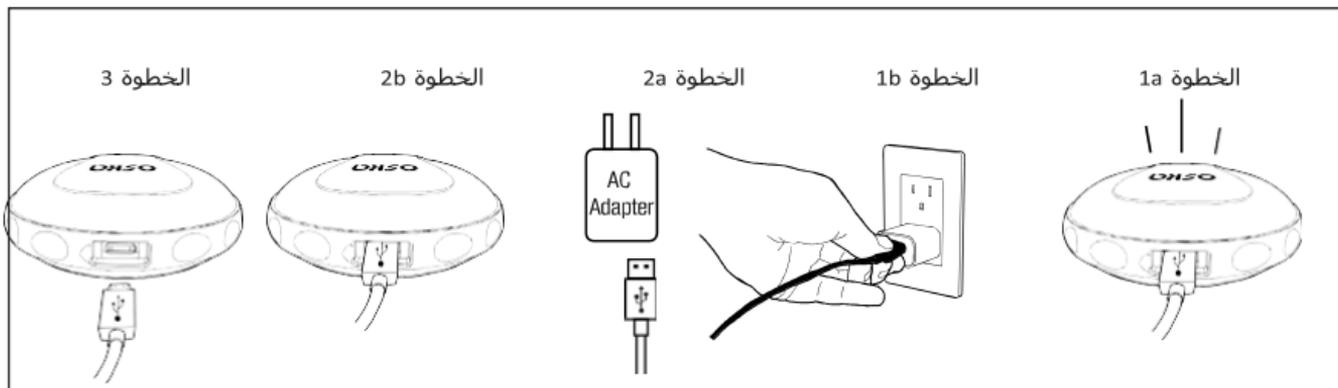

الشكل 2: شحن Oska Pulse الخاص بك

⚠ أثناء عملية الشحن، لا تضع المعدات بطريقة يصعب معها فصل إمدادات الطاقة.

محول شحن التيار المتردد الذي تم توفيره مع Oska Pulse هو محول معتمد من الدرجة الطبية (Globtek، النوع 1005-USB-GTM46101). اتصل بـ Oska أو Inc. أو الموزع المحلي للحصول على بديل. في حالة استخدام محول AC آخر غير الذي قد زودتك به Oska، فيرجى التأكد من وجود محول معتمد لمعيار سلامة الجهاز الطبي (IEC 60601-1) مع إخراج مميز من الفئة 2 أو تلبية متطلبات مصدر الطاقة المحدود (LPS)، وعدم تجاوز V16.



عندما يتم توصيل الجهاز بمصدر طاقة، ستضيء مصابيح LED في الطرف الآخر. إذا تم استنفاد البطارية بالكامل، فقد تستغرق مصابيح LED بضع دقائق للإضاءة. ستظل مصابيح LED مضاءة (وليس موجة نابضة) أثناء شحن الجهاز، ثم تختفي عند اكتمال الشحن. قد تستغرق البطارية ثلاث (3) ساعات أو أكثر لشحنها بالكامل. قد يختلف وقت شحن البطارية حسب الظروف البيئية.

يمكن أن توفر البطارية المشحونة بالكامل عشرة (10) جلسات أو أكثر لمدة 90 دقائق. يمكن أن يختلف وقت تشغيل الجهاز (+/-10%) بسبب ظروف التشغيل.

قد ينخفض عمر البطارية بعد الاستخدام المطول. تشير التقديرات إلى أن البطارية تستمر بين 200 و 500 دورة شحن، ولكن العمر قد يختلف. يمكن أن يؤدي تخزين الجهاز دون شحن إلى تقليل عمر البطارية. البطارية غير قابلة للاستبدال.

8. تشغيل OSKA PULSE

التشغيل

اضغط على الزر الموجود أعلى الجهاز وأطلقه لتشغيله على Oska Pulse. سيصدر الجهاز صافرة خافتة. ستبدأ مصابيح LED في النبض في محيط الجهاز للإشارة إلى انبعاث PEMF. تبدأ جلسة PEMF بمجرد تشغيل الجهاز. سيبدأ الجهاز جلسة جديدة في كل مرة يتم تشغيله فيها.

ملاحظة: لن يشعر معظم الأفراد بالمجال الكهرومغناطيسي (PEMF) بسبب مدى تردده المنخفض. هذا طبيعي ومتوقع. علاج Oska Pulse غير جراحي.

إيقاف الطاقة |

Oska Pulse معد مسبقاً للعمل لمدة 90 دقيقة دون انقطاع، ثم يتم إيقاف تشغيله تلقائياً عند اكتمال المدة. يمكن إيقاف الجلسة مبكراً عن طريق الضغط بسرعة وبشكل متكرر على زر الطاقة لثلاث (3) مرات. سيصدر الجهاز صوتاً وستطفأ مصابيح LED للإشارة إلى تشغيل الجهاز



الشكل 3: قم بتشغيل Oska Pulse الخاص بك

البطارية منخفضة

عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، سيصدر الجهاز صفيراً عدة مرات أثناء تشغيله.

يشير تسلسل الصغير الممتد إلى أنه يجب شحن الجهاز (انظر القسم 7، شحن OSKA PULSE). سيتم إيقاف تشغيل Oska Pulse مبكرًا، قبل اكتمال مدة 90 دقائق كاملة، إذا تم الوصول إلى مستوى بطارية منخفض حرج خلال جلسة نشطة.

الاستخدام الموصى به

بشكل عام، يوصى بإكمال جلستين (2) أو أكثر- وتستمر الجلسة لمدة 90 دقائق كل يوم. حافظ على الاستخدام أو ضبطه وفقًا لاستجابة جسمك. يمكن تقسيم الجلسات إلى أوقات مدتها ساعة واحدة. ومع ذلك، يوصى بالاستخدام اليومي المتسق لتحقيق أقصى قدر من النتائج.


قد يختلف الاستخدام المناسب حسب حالة المستخدم المحددة. استشر طبيبك لتحديد الاستخدام الموصى به لحالتك الفردية.

اشرب الكثير من الماء للحفاظ على الترطيب ومساعدة جسمك على تعظيم الفوائد.



9. استخدام لفافات الانضغاط

يتم تضمين لفافات الانضغاط في حزمة المجموعة. اللفافات مرنة للمساعدة في تأمين Oska Pulse على المنطقة المستهدفة أو بالقرب منها. تم تصميم الأغطية لاستخدامها واحدة تلو الأخرى. استخدم الغلاف الذي يوفر أفضل ملاءمة.



الخطوة 1: قم بإخراج الجهاز في الحلقة الموجودة في نهاية الشريط، وملصق Oska وأعلى الجهاز الموجود لأعلى. تأكد من أن نهايات الجهاز مرئية، والجهاز متمركز وآمن.



الشكل 4: لفافات

الخطوة 2: ضع الجهاز على المنطقة المستهدفة أو بالقرب منها. يمكن ارتداء Oska Pulse تحت أو فوق الملابس.

ملاحظة: يمتد المجال الكهرومغناطيسي حوالي 28 سم من الجهاز، في جميع الاتجاهات. القوة المثلى في حدود 20 سم. كلما زادت المسافة من الجهاز، ضعفت قوة المجال المغناطيسي.

الخطوة 3: اربط اللفافة حول طرفك أو جذعك أو منطقة الهدف الأخرى واربطه بالخطاف والحلقة


يحتوي غلاف الضغط على مادة اللاتكس المطاطية الطبيعية التي قد تسبب تفاعلات تحسسية

لا تضع الغلاف بإحكام شديد لأنه قد يؤثر على الدورة الدموية، خاصة عند استخدامه لفترة طويلة.






لا تنس أنك ترتدي *Oska Pulse* وتعمل على تعريض الجهاز عن طريق الخطأ للماء أو السائل أو الظروف البيئية غير المناسبة. في حالة حدوث ذلك، لا تستخدم أو تشحن الجهاز. المعرض - من المؤكد أن السوائل قد تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للمكونات الإلكترونية.

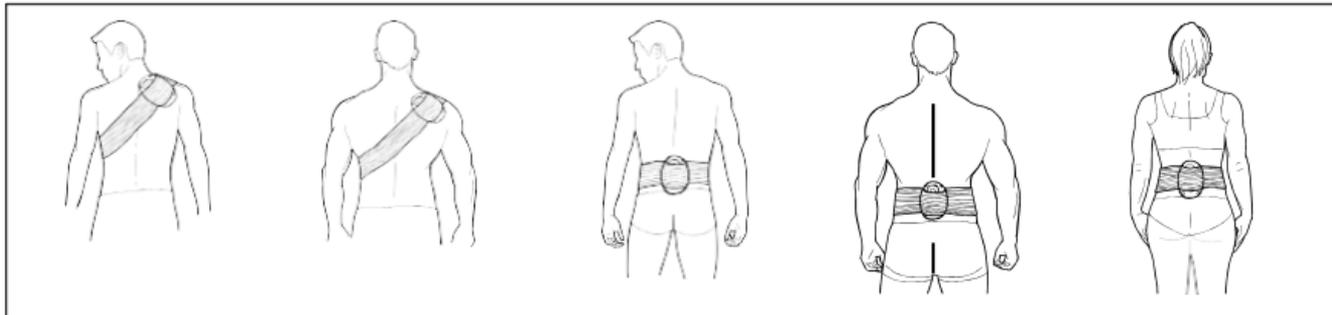

الشكل 5: أمثلة على ارتداء حزام ضغط على

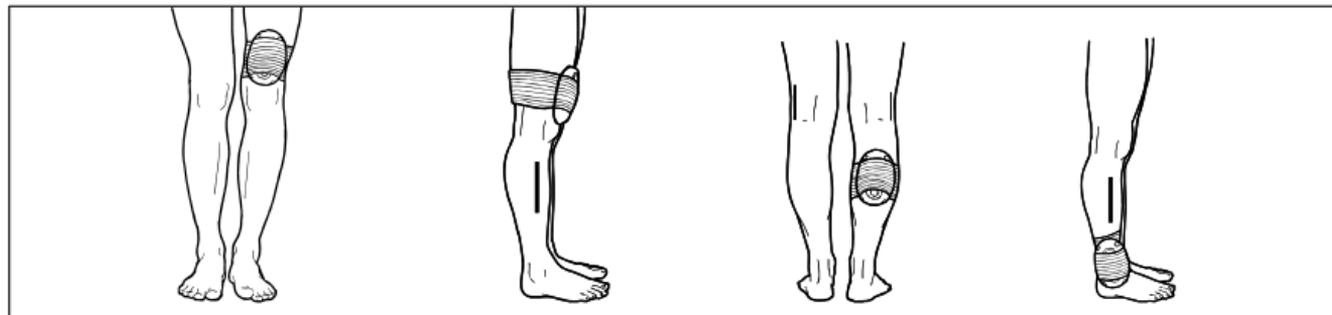

الشكل 6: أمثلة على ارتداء لفافة الانضغاط

10. العناية بالأجهزة وصيانتها

- نظف سطح **Oska Pulse** منطقة السيليكون بقطعة قماش مبللة قليلاً فقط.
- نوصي بتطهير الجهاز بقطعة قماش معقمة أو ممسحة بنسبة 70٪ من كحول الإيزوبروبيل بشكل دوري.
- قم دائماً بحفظ **Oska Pulse** في مكان بارد وجاف. لا تحتفظ به أبداً حيث تكون درجة الحرارة أقل من -10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت) أو أكثر من 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت).
- اغسل غلاف الضغط يدوياً باستخدام الماء الدافئ ومنظف الغسيل المنزلي. تعليق أو وضع مسطح إلى الهواء جاف.
- لا تحفظ **Oska Pulse** أو أي من أجزائها في سيارة في طقس بارد أو حار.
- توخى الحذر قبل استخدام الجهاز في حالة تخزين أو عدم استخدام **Oska Pulse** لفترات طويلة. افحص الجهاز ولا تستخدمه إذا رأيت أي علامات على تسرب بطارية داخلية.
- لا تخزن **Oska Pulse** أبداً لفترة طويلة مع استنفاد شحنة البطارية.
- لا تستخدم أو تشحن **Oska Pulse** بعد غمره أو إسقاطه في أي سائل لأن التعرض للسوائل قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للمكونات الإلكترونية.
- لا تستخدم الصابون أو المنظف أو المبيض أو أي عامل تنظيف آخر قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

11. استكشاف المشاكل وإصلاحها

إذا واجهت أي مشكلة في تشغيل الجهاز، فقم أولاً بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم عد مرة أخرى) انظر القسم 8، تشغيل(OSKA PULSE). سيسمح هذا لبرمجة e-Tec بإعادة تشغيل نفسها وإعادة ضبطها. بعد ذلك، تأكد من شحن الجهاز بشكل كافٍ (انظر القسم 7، شحن OSKA PULSE). إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بالموزع المحلي. للحصول على معلومات الاتصال، قم بزيارة: www.oskawellness.com/pages/contact.

12. الوصف التقني

يتكون Oska Pulse من ملف نحاسي يولد مجالاً مغناطيسياً. يستخدم مولد التردد لتنشيط الملف لإنشاء مجال كهرومغناطيسي نبضي. يمكن أن يؤثر المجال الكهرومغناطيسي النبضي على مسار نقل الإشارة وربط الأيونات وانتقال الأيونات عبر غشاء الخلية البشرية. وهو قادر على زيادة نقل أيونات الكالسيوم (Ca^{++}) مما يؤدي إلى إصلاح الأنسجة وتجديدها.

13. المواصفات

Oska, Inc.	الشركة المصنعة
Oska Pulse	اسم الجهاز
90-Minute	اسم النموذج/البديل
CS011A	رقم جزء النموذج/البديل
90 دقيقة	وقت العملية
المريض أو المستخدم	المشغل
10°C (50°F) to 38°C (100°F)	درجة حرارة التشغيل
700 hPa to 1060 hPa	تشغيل الضغط الجوي
الحد الأقصى 95% الرطوبة النسبية، عدم التكثيف	التحكم بالرطوبة
10- درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت) إلى 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التخزين والنقل
700 to 1060 hPa	التخزين والنقل الضغط الجوي
الحد الأقصى 95% الرطوبة النسبية، غير المكثفة	التخزين والنقل والرطوبة
IP22	الحماية من دخول الجسيمات الصلبة والسائل
2.12 أوقية (60 جرامًا)	الوزن
5.25 بوصة × 3.50 بوصة × 1.25 بوصة (13.3 سم × 8.9 سم × 3.2 سم)	الأبعاد
3.7V بطارية «لي أيون» قابلة للشحن البطارية غير قابلة للاستبدال.	بطارية قابلة لإعادة الشحن
Globtek, type GTM46101-1005-USB Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 0.3A Output: 5VDC, 2A	شاحن إمدادات الطاقة الخارجية
مساحة سطح الجهاز التي تتصل بمنطقة (مناطق) المعالجة.	الجزء المطبق

14. حرف او رمز

الوصف	الرمز
رمز الشركة المصنعة	
تاريخ الصنع	
بلد الصنع	
رقم النموذج أو رقم الجزء.	#
رقم تسلسل الجهاز.	SN
تحديد الجهاز الفريد.(UDI)	UDI
العنصر هو جهاز طبي.	MD
التوافق مع العلامة الأوروبية. تعلن الشركة المصنعة أن المنتج يتوافق مع اللوائح الأوروبية المعمول بها.	CE
تم اعتماد Nemko للامتثال لمعايير السلامة الكهربائية و EMC ذات الصلة	
الامتثال للسلامة الكهربائية لـ UL 1431 و CAN/CSA C22.2 رقم 68.	
شهادة KC لسلامة المنتجات الإلكترونية في كوريا الجنوبية.	
الممثل المأذون له في الاتحاد الأوروبي	EC REP
يرجى الرجوع إلى دليل/كتيب التعليمات.	

14. حرف او رمز (واصلت)

الوصف	الرمز
ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية على الموقع الشبكي	
يمكن استخدام الجهاز الطبي عدة مرات على مريض واحد	
تحذير أو انتباه، وعي المشغل مطلوب لتجنب العواقب غير المرغوب فيها	
يحتوي على مادة اللاتكس المطاطية الطبيعية التي قد تسبب تفاعلات تحسسية	
دخول مرتبة الجسيمات السائلة والصلبة	IP22
كيان يستورد الجهاز الطبي إلى الموقع	
الجزء المطبق BF	
نطاق درجة الحرارة	
نطاق الرطوبة (نسبية غير مكثفة)	
تخصيص نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لجمعها بشكل منفصل في نقطة تجميع مناسبة. لا تتخلص من النفايات المنزلية.	
تقييد المواد الخطرة EU/التوجيه الأوروبي 65/2011	

15. معلومات بخصوص الضمان

ضمان الجهة المصنعة

من الضروري أن يكون جهاز **Oska Pulse** خاليًا من عيب الشركة المصنعة في المواد والصناعة لمدة عام واحد (1) من تاريخ الشراء، رهنًا بالاستخدام العادي للجهاز. يتم استبعاد الملحقات من ضمان الشركة المصنعة. عادة ما يكون عمر **Oska Pulse** أطول بكثير من عام واحد، اعتمادًا على تواتر ومدة الاستخدام.

مدة الضمان لأجهزة **Oska Pulse** المشتراة في ألمانيا (DEU) هي سنتان (2) من تاريخ الشراء. يمتد ضمان الشركة المصنعة هذا فقط إلى مشتري الجهاز الأصلي طالما تم شراؤه مباشرة من خلال **Oska**، **Inc.**، أو شركة تابعة أو موزع أو بائع تجزئة معتمد من **Oska Pulse**. إذا كنت تعتقد أن منتجك معيوب خلال فترة الضمان، أو معطل، فيرجى الاتصال بموزع محلي أو ممثل دعم **Oska**. مطلوب تصريح مواد الإرجاع (RMA) كموافقة لبدء عملية الضمان.

تحتفظ شركة **Oska**، **Inc.** بالحق في تحديد ما إذا كان المنتج معيَّبًا ومؤهلًا لاستبدال الضمان. أيضًا، تحتفظ **Oska** بالحق في تغيير الطريقة التي يتم بها تقديم خدمة الضمان، وأهلية المنتج لتلقي طريقة خدمة معينة. يرجى الاطلاع على أحدث سياسة ضمان متاحة على www.oskawellness.com/pages/warranty، أو الاتصال بشركة **Oska**، **Inc.** مباشرة على support@oskawellness.com أو (+) 9932-630-844.

